




LIFEPAK[®] 12

DÉFIBRILLATEUR / MONITEUR

Accessoires authentiques de Physio-Control

LIFEPAK 12 DÉFIBRILLATEUR / MONITEUR

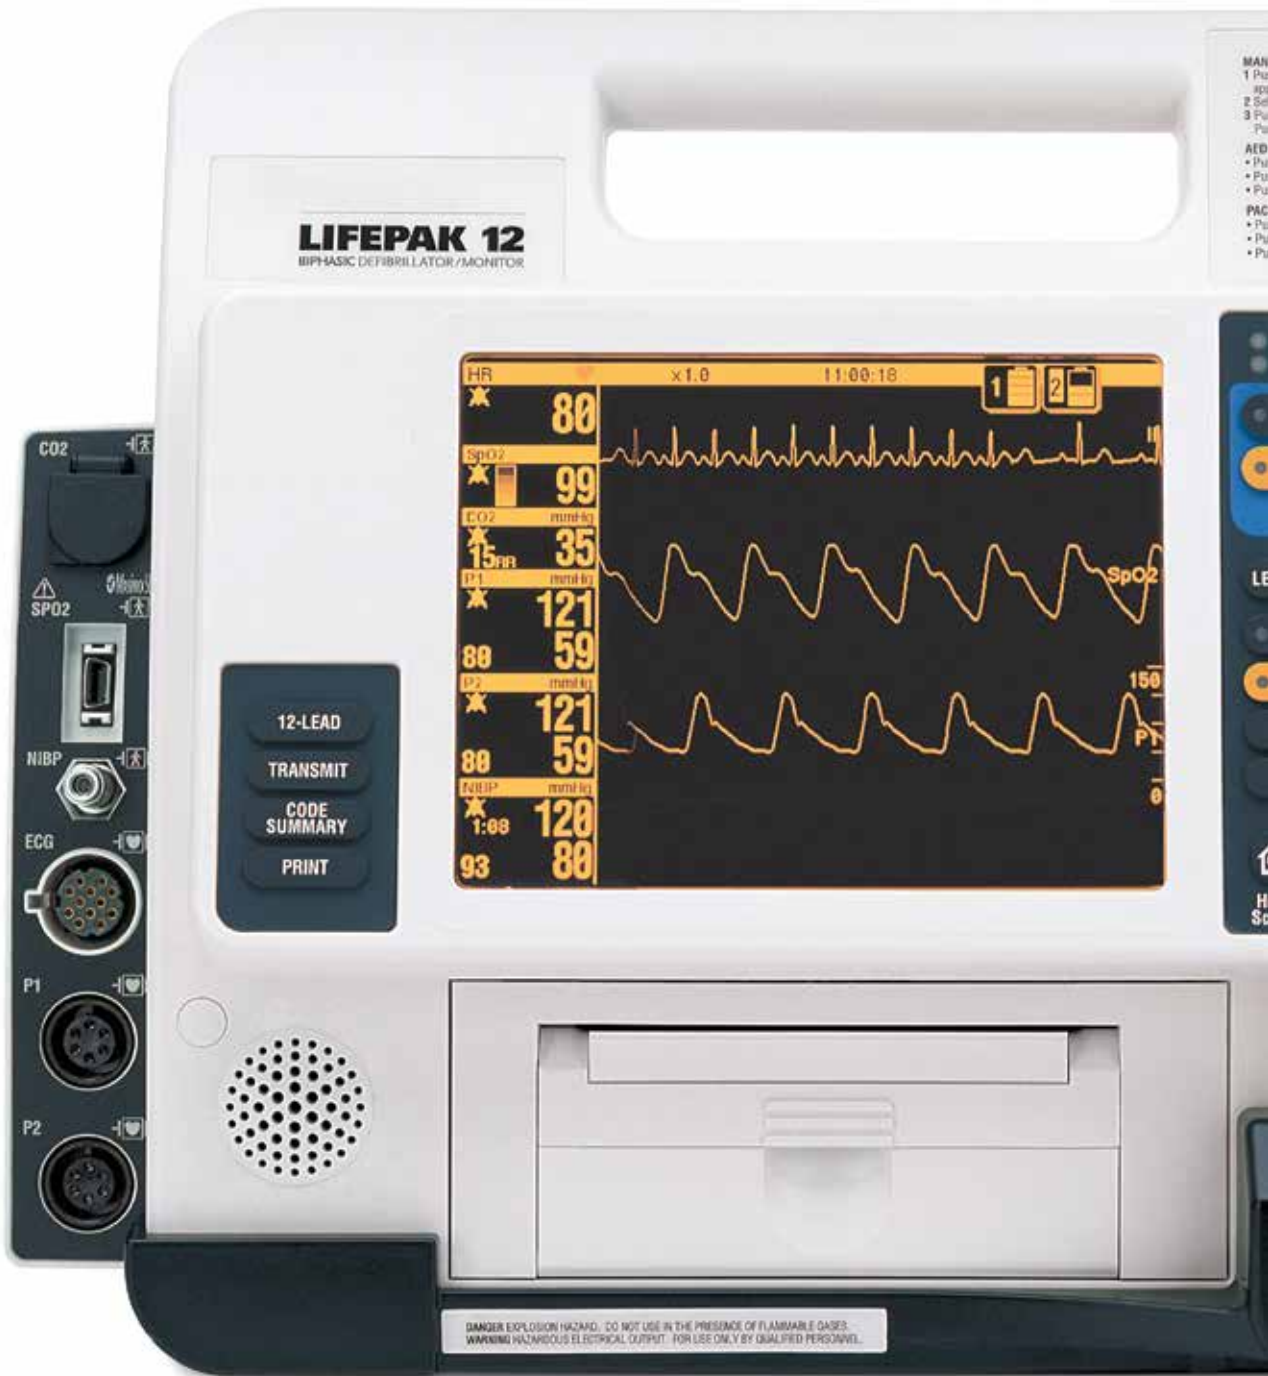



Accessoires authentiques de Physio-Control

Pour une sécurité optimale de votre personnel et de vos patients. Seuls les accessoires et consommables Physio-Control ont été testés de façon exhaustive avec les produits LIFEPAK. Choisissez un nom de confiance venant d'une société réputée. Veuillez contacter votre représentant Physio-Control pour les commandes.

Options d'alimentation



Base REDI-CHARGE

Chargeur de base universel, utilisé avec bacs interchangeables pour charger les batteries lithium-ion de LIFEPAK 12 et 15. (Câble d'alimentation CA, batteries et bacs vendus séparément.)

11141-000115



Bac adaptateur pour LIFEPAK 12 REDI-CHARGE®

Bac adaptateur à utiliser avec batteries lithium-ion de LIFEPAK 12 et base REDI-CHARGE. (Batteries et base vendues séparément)

11141-000116



Batterie lithium-ion rechargeable 7.2

À utiliser avec REDI-CHARGE uniquement

11141-000106

Câble d'alimentation CA

11140-000015 (États-Unis)

11140-000019 (Europe)

11140-000023 (Afrique du Sud)

11140-000045 (Non fini)

11140-000017 (Australie)

11140-000022 (Royaume Uni)

11140-000045 (Suisse)

Accessoires de surveillance PNI



Brassard réutilisable

Adulte, X-Large

35 - 44 cm

11160-000009

Pédiatrique

13 - 20 cm

11160-000003

Adulte, Large

32 - 42 cm

11160-000007

Nourrisson

8 - 14 cm

11160-000001

Adulte

26 - 35 cm

11160-000005



Brassard à usage unique (un seul patient)

Adulte, X-Large

35 - 44 cm

11160-000010

Pédiatrique

13 - 20 cm

11160-000004

Adulte, Large

32 - 42 cm

11160-000008

Nourrisson

8 - 14 cm

11160-000002

Adulte

26 - 35 cm

11160-000006



Tubes PNI

11996-000033 (2,75 m)

11996-000089 (3,65 m)

11996-000125 (0,6 à 2,75 m)

Options d'alimentation



Station mobile pour batteries (MBSS)

Opération en CC et CA pour applications mobiles en cours de transport, à utiliser avec l'une des batteries ci-dessous. Câble d'alimentation CA, support de montage et manuel inclus. (Batteries et câble d'alimentation CA non inclus.)

82100008

Câble CC de 12 volt pour chargeur MBSS

48-82300029



Adaptateur d'alimentation CA, anglais international

À utiliser avec batteries LIFEPAK 12 SLA uniquement

11400-000038 (120 volt)

11400-000044 (230 volt)

Câble rallonge pour adaptateur d'alimentation

11110-000051



Batterie NiCd LIFEPAK

Capacité de 1,6 Ah, rechargeable, nickel-cadmium, avec jauge de charge.

11141-000149



Batterie SLA LIFEPAK

Capacité de 2,5 Ah, rechargeable, acide-plomb scellée (SLA).

11141-000028

Accessoires de Surveillance ECG



Câble de liaison ECG 12 dérivation
avec câbles membres 4 brins

11111-000018 (1,5 m, AHA)
11111-000019 (1,5 m, IEC)
11111-000020 (2,4 m, AHA)
11111-000021 (2,4 m, IEC)



Attache précordiale 6 brins pour câble ECG 12 dérivation

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Serre-câble 4 brins

21300-008054 (boîte de 10)

Serre-câble 6 brins

21330-008055 (boîte de 10)



Câble ECG 3 brins

Connecteur à angle droit
11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



Câble ECG 5 brins

Connecteur à angle droit, 4 dérivation
membres plus 1 dérivation poitrine, étiquetée
"V1".
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)

Électrodes Cleartrace[®] ECG

Adulte (Disponibles dans l'Union Européenne.)
1700-003 (boîte de 3)



Électrodes LIFE-PATCH ECG

Adulte, prégélifiées. (Non disponibles dans
l'Union Européenne.)
11100-000002 (boîte de 4)
11100-000001 (boîte de 3)



Bandelettes de papier pour enregistreur

11240-000016 (100 mm x 22 m, 2 rouleaux
par boîte)
11240-000013 (50 mm x 22 m, 2 rouleaux
ar boîte)

Accessoires de thérapie

Palettes dures et gel pour électrodes



Palettes dures standard (1 paire)

11130-000001 (Anglais)
11998-000040 (Français)
11998-000041 (Allemand)
11998-000042 (Espagnol)
11998-000043 (Italien)
11998-000044 (Suédois)
11998-000045 (Danois)
11998-000046 (Portugais)
11998-000047 (Norvégien)
11998-000048 (Néerlandais)
11998-000049 (Finlandais)
11998-000050 (Polonais)
11998-000301 (Japonais)



Palette pédiatrique, externe

Se glisse sur une palette standard adulte.
11133-000001 (2 nécessaires)



Gel pour électrodes SIGNAGEL®

À utiliser avec les palettes dures. Électrolyte hautement conducteur, multi-usage, répondant aux normes d'un gel électrode salin idéal.
21300-005847 (Tube de 240 g)



Palettes internes (1 paire)

Nécessite des poignées de palettes internes

Taille de 2,5 cm

11131-000010 (tige de 16 cm)

Taille de 3,8 cm

11131-000011 (tige de 15 cm)

11131-000021 (tige de 23 cm)

11131-000024 (tige de 35 cm)

Taille de 5 cm

11131-000012 (tige de 14.6 cm)

11131-000022 (tige de 22 cm)

Taille de 7,5 cm

11131-000013 (tige de 14 cm)

11131-000019 (tige de 21,6 cm)

Taille de 8,9 cm

11131-000014 (tige de 12,7 cm)

11131-000023 (tige de 20,3 cm)



Poignée pour palette interne avec contrôle de la décharge

11131-000001 (1 paire)

Accessoires de thérapie

Électrodes EDGE System™ pour stimulation/défibrillation/ECG avec connecteur QUIK-COMBO®

Durée de stockage de 18 mois minimum, sauf indication spécifique



Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000091 (Longueur de câble : 60 cm)



Électrodes EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000090 (Longueur de câble : 60 cm)



Électrodes pédiatriques EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO

À utiliser uniquement avec les moniteurs/défibrillateurs manuels ; durée de stockage de 12 mois min. à partir de l'expédition.

11996-000093 (Longueur de câble : 60 cm)



Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO et système de préconnexion REDI-PAK™

11996-000017 (Longueur de câble : 1,07 m)



Câble de thérapie QUIK-COMBO

À utiliser avec les moniteurs/défibrillateurs LIFEPAK 12.

11113-000040



Câble adaptateur FAST-PATCH®

À utiliser avec le câble de thérapie QUIK-COMBO pour défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.

11110-000052

Autres électrodes EDGE System™ pour stimulation/défibrillation/ECG



Électrodes EDGE System avec connecteur FAST-PATCH

Doivent être utilisées avec le câble adaptateur QUIK-COMBO – FAST-PATCH (11110-000052)

11996-000092

Accessoires de Surveillance SpO₂

Câbles patients Masimo LNC réutilisables



Câble patient LNCS

- 11171-000024** (1,2 m)
- 11171-000016** (3 m)
- 11171-000025** (4,25 m)
- 11171-000027** (rallonge de 1,2 m)

Capteurs SpO₂ uniquement, compatibles avec câbles patients Masimo LNC et



Capteur adhésif LNCS

Usage unique (un seul patient). (boîte de 20)

- 11171-000019** (Ad)
- 11171-000019** (Péd)
- 11171-000029** (Néonat/préma)
- 11171-000028** (Néonat/ad)
- 11171-000031** (Nourrisson)



Capteur LNCS réutilisable

- 11171-000017** (Ad)
- 11171-000018** (Péd)



Capteur LNCS souple réutilisable

- 11171-000052** (Ad)

Capteurs à connexion directe Masimo réutilisables et câbles



Capteur à connexion directe réutilisable

- 11171-000051** (Ad)

Accessoires de Surveillance SpO₂

Câbles patients Masimo® LNOP



Câble patient LNOP

11171-000006 (1,2 m)
11171-000008 (2,4 m)
11171-000009 (3,65 m)

Capteurs SpO₂ uniquement, compatibles avec câbles patients Masimo LNOP



Capteur LNOP réutilisable

11171-000007 (Ad)
11171-000010 (Péd)



Capteur adhésif LNOP (Boîte de 20)

11171-000011 (Ad)
11171-000012 (Péd)



Capteur adhésif LNOP (Boîte de 20)

11171-000014 (Néonatal/préma)
11171-000013 (Néonatal)
11171-000036 (Nourrisson)

Accessoires supplémentaires et câbles d'adaptateurs



Protection lumière ambiante réutilisable

11171-000054 (boîte de 5)



Protection lumière ambiante à usage unique

11171-000055 (boîte de 10)



Câble adaptateur MNC-1

Permet de connecter un défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 avec SpO₂ Masimo aux capteurs Nellcor.

11996-000183 (3 m)
11996-000198 (1,2 m)

Capteurs SpO₂ et câbles

Capteurs Nellcor réutilisables



Capteur à clip DURASENSOR réutilisable
11996-000060 (Ad)

Capteur multisite DURA-Y réutilisable
11996-000106 (> 1 kg)



Capteur Oxiband réutilisable

50 bandes adhésives à usage unique incluses

11996-000061 (Ad/Néonate)

11996-000062 (Péd/nourrisson)

Bande adhésive à usage unique

Non disponible au Canada. (boîte de 100)

11996-000048 (Ad/Néonate)

11996-000049 (Péd/nourrisson)

Bande mousse adhésive à usage unique

Non disponible au Canada. (boîte de 100)

11996-000110 (Ad/Néonate)

11996-000108 (Péd/nourrisson)

Capteurs Nellcor à usage unique (un seul patient)



Oxisensor II (boîte de 24)

Adulte

11996-000113 (45 cm)

11996-000114 (90 cm)

Pédiatrique

11996-000116 (45 cm)



Oxisensor II (boîte de 24)

Nourrisson

11996-000115 (45 cm)

Néonatal/adulte

11996-000117 (45 cm)

Accessoires de surveillance de la capnographie (EtCO₂)

Lignes de prélèvement Oridion® Filterlines pour patients intubés

Usage unique (un seul patient)



FilterLine® SET

Applications principales : bloc opératoire, AMU, urgences, équipes d'intervention rapide, transport.

Adulte/pédiatrique

11996-000081 (boîte de 25, 200 cm)

11996-000164 (boîte de 25, 400 cm)



FilterLine H SET

Applications principales : soins critiques, environnements humidifiés.

Adulte/pédiatrique

11996-000080 (boîte de 25, 200 cm)

Adulte/néonatal

11996-000001 (boîte de 25, 200 cm)

Lignes de prélèvement Oridion Filterlines pour patients non-intubés



Smart CapnoLine® Plus

Applications principales : sédation en vue d'une intervention, procédures du tractus GI supérieur, MAC (Anesthésie surveillée), RMS, BD, équipes d'intervention rapide.

Adulte avec O₂

11996-000163 (boîte de 25, 200 cm)

11996-000167 (boîte de 100, 200 cm)

11996-000165 (boîte de 25, 400 cm)

Adulte sans O₂

11996-000162 (boîte de 25, 200 cm)

11996-000166 (boîte de 100, 200 cm)



Smart CapnoLine

Applications principales : sédation en vue d'une intervention, SMS, SD, équipes d'intervention rapide

Pédiatrique avec O₂

11996-000128 (boîte de 25, 200 cm)

Pédiatrique sans O₂

11996-000120 (boîte de 25, 200 cm)

Sacoches



Sacoche de transport de base

Bandoulière, poches droite et gauche et protection frontale incluses.

11260-000030

Sacoche de transport à utiliser avec adaptateur d'alimentation CA

Bandoulière, poches droite et gauche et protection frontale incluses.

11260-000032

Protège-écran amovible en acrylique

Protège-écran en acrylique dur pour protéger l'écran (Ne peut pas être utilisé avec la protection frontale.)

11998-000063

Poche droite de remplacement

(Incluse avec la sacoche de base.)

21300-007203

Poche gauche de remplacement

(Incluse avec la sacoche de base)

21300-007201

Bandoulière de remplacement

11260-000037

Protection frontale de remplacement

Protection en plastique souple pour l'écran et les claviers. Ne peut pas être utilisée avec le protège-écran amovible en acrylique. (Incluse avec la sacoche de base.)

11220-000033

Sacoche de transport à utiliser avec enregistreur vocal

Bandoulière, poches droite et gauche et protection frontale incluses.

11260-000033

Supports de base et latéraux de la sacoche de transport (remplacement)

21300-006361

Protecteur du connecteur de thérapie

Recommandé pour protéger le connecteur de thérapie du défibrillateur/moniteur contre les impacts directs en cours d'utilisation. S'attache en permanence au rebord inférieur à l'avant du défibrillateur/moniteur.

21330-001112

Écran du connecteur de thérapie

Recommandé pour protéger le connecteur de thérapie, en alternative au protecteur du connecteur de thérapie. S'attache au défibrillateur/moniteur à l'aide de bandes VELCRO®.

21330-006463



Poche Arrière

Idéale pour le rangement d'accessoires supplémentaires. (Non recommandée pour utilisation avec batteries SLA.)

11260-000029



Poche Supérieure

Logement pour capteurs et électrodes, à insérer à la place des palettes standard.

11220-000028

Accessoires de communication et de fixation



Câble de liaison moniteur LIFEPAK – ordinateur

Pour connecter un moniteur/défibrillateur LIFEPAK 12 ou 15 à un ordinateur.

11230-000020 (Série)

11996-000369 (USB)

Câble de transfert pour configuration LIFEPAK

11110-000183



Passerelle 3G

Pour la transmission de données du LIFEPAK 12/15 au système LIFENET™ ou au logiciel de visualisation des données CODE-STAT™. Nécessite un plan de données.

21996-000086 (Passerelle Verizon)

99428-000305 (Plan de données Verizon)

21996-000082 (Passerelle AT&T)

99428-000304 (Plan de données AT&T)



Passerelle sans fil Titan Ily

Pour la transmission de données du LIFEPAK 12/15 au système LIFENET ou au logiciel de visualisation des données CODE-STAT. Nécessite un réseau sans fil existant.

11996-000373

11996-000375 (avec enregistrement vocal)

Accessoires de fixation et support à pied roulant



Support mobile à pied roulant LIFESTAND™ pour le défibrillateur/ moniteur LIFEPAK 12

11996-000157



Support de montage sur surface

Conçu pour monter le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 dans une ambulance. Le support est léger et peut être utilisé dans un avion ou hélicoptère.

11996-000309

Support de montage

Support de montage pivotant à droite ou à gauche pour le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12. (Disponible en Europe.)

82300037

Testeurs et matériels de formation



Simulateur d'état du patient

(QUIK-COMBO)

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies et bradycardies, ainsi que des anomalies du segment ST et de l'onde T.

11996-000311 (12 dérivations)

11996-000310 (3 dérivations)

Vidéo de mise en service :

26500-002186 (DVD NTSC en anglais)

Manuel d'entretien

21500-006152 (CD Rom)

Mode d'emploi

26500-002481 (Anglais)

26500-002482 (Anglais international)

26500-002483 (Allemand)

26500-002484 (Italien)

26500-002485 (Français)

26500-002486 (Néerlandais)

26500-002487 (Espagnol)

26500-002495 (Portugais)

26500-002496 (Suédois)

26500-002488 (Danois)

26500-002492 (Finlandais)

26500-002494 (Norvégien)

26500-002489 (Polonais)

26500-003413 (Japonais)



Électrodes de formation réutilisables

À utiliser avec les simulateurs d'état du patient QUIK-COMBO. Permet aux utilisateurs de s'entraîner à bien positionner les électrodes de défibrillation.

11250-000052 (5 paires)

11101-000003 (5 paires de remplacement)



Testeur de défibrillation

Teste l'énergie délivrée à l'aide de palettes dures standard. Un néon lumineux indique que l'énergie a été délivrée.

11998-000060



Testeur de câble

Utilisé pour tester la performance du câble de thérapie. Se branche au câble de thérapie QUIK-COMBO du défibrillateur.

21330-001365 (Anglais uniquement)

21330-001366 (Anglais, suédois, danois, finlandais, norvégien)

21330-001367 (Anglais, allemand, italien, français, néerlandais, espagnol)

21330-001368 (Anglais, espagnol, portugais, polonais, hongrois)

21330-001369 (Anglais, chinois, coréen, japonais)

Pour de plus amples informations, contactez Physio-Control ou visitez le site web www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
1015 CJ Amsterdam, NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

Physio-Control BENELUX
Physio-Control Operations
Netherlands B.V.
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht, NL
Tel +32 (0)70 222 098
Fax +32 (0)70 222 137
www.physio-control.nl

**Physio-Control
France Sales S.A.R.L.**
13 rue Camille Desmoulins
92130 Issy Les Moulineaux
Tél + 33 1 70 36 86 98
Fax + 33 1 58 04 27 29
www.physio-control.fr

**Physio-Control
Canada Sales, Ltd.**
7111 Syntex Drive, 3rd Floor
Mississauga, ON
L5N 8C3, Canada
Toll free 800 895 5896
Fax 866 430 6115